AMCP1409/series NEOFLOW®
CIRCUITOS CALEFACTADOS PARA NCPAP

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS

- Circuito calefactado NeoFlow para sistema de nCPAP, con cámara de humidificación autorrellenable, ramal calefactado de 1,2 m, ramal de conexión a máquina de 0,3 m y conexión para generador de NCAP NeoFlow.
- La mayoría de modelos, además del circuito, incluyen generador NCPAP, soporte para Gorro NeoFlow y silenciador. Observe la tabla de referencias o contáctenos para mas información.
- Protegido frente a la colonización de microorganismos con la tecnología **BioCote®**. El circuito contiene iones de plata introducidos en el proceso de inyección del tubo. BioCote® es efectivo frente a un amplio rango de microorganismos.
- Existen diferentes versiones disponibles para conectar el circuito a la mayoría de la maquinaría disponible en el mercado.
- Usado en combinación con el gorro NeoFlow se reducen notablemente los problemas de fijación que producen otros sistemas de nCPAP disponibles en el mercado.
- El circuito puede transformarse en un circuito de alto flujo de Oxigeno con el kit de transición, permitiendo la utilización de este circuito en un mismo paciente para suministrar 2 terapías distintas, reduciendo costes y tiempo.
- Compatible con calentador Fisher & Paykel 850, 730 y Aquavent 2600A. Flexible, ligero y resistente a los acodamientos reduciendo al mínimo el riesgo de oclusión.
- Producto de un solo uso, en un paciente.
- Vida útil del circuito: 7 días.

IMÁGENES DEL PRODUCTO

AMCP1409/series NEOFLOW®
CIRCUITOS CALEFACTADOS PARA NCPAP

TABLA DE REFERENCIAS

Referencia	Descripción	Generador de nCPAP	Línea incubadora	Silenciador	Conectores Óxido Nítrico
AMCP1409/037	Circuito nCPAP SIPAP/Fabian	Si	Si	Si	No
AMCP1409/044	Circuito nCPAP Infant Flow SIPAP	Si	Si	Si	No
AMCP1409/057	Circuito nCPAP C/Kit Óxido Nítrico	Si	Si	Si	Si
AMCP1409/013	Circuito nCPAP	No	Si	Si	No
AMCP1409/043	Kit de Transición de NCPAP a Alto Flujo	No	No	No	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- Circuito: Polietileno de baja densidad, Resina-K, Silicona, ABS, Aluminio, PVC, SBS y Polipropileno.
- Generador de NCPAP: Polipropileno, Poliéster, Poliestireno, Resina-k, ABS y PVC.
- Puntas Nasales: Silicona.

LIBRE DE

- Latex.
- DEHP Phtalatos.
- Formalina.
- Materias primas a base de fósforo.
- Plásticos halogenados.

DOCUMENTOS DE SOPORTE

- Declaración de conformidad.
- Instrucciones de uso técnicas (IFU).
- Guía de Uso (GFU).
- Catálogo NeoFlow.

CONFORMIDAD

- Producto de Clase IIA (no estéril) de acuerdo a la Directiva 93/42 EC, modificada por 2007/47EC
- CE0120
- Todos los productos de Armstrong Medical están fabricados bajo el Sistema de Calidad ISO 13485.

AMCP1409/series NEOFLOW®
CIRCUITOS CALEFACTADOS PARA NCPAP

Plano técnico de componentes

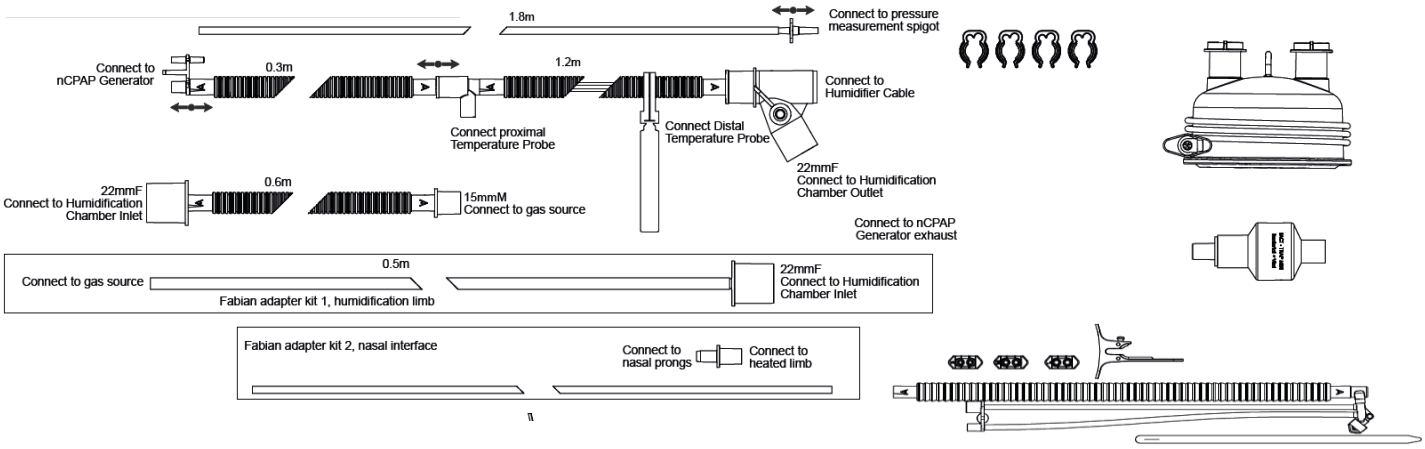

Fabricado por:

Armstrong Medical
Newbridge Road Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland
Telf: +44 (0)28 7035 6029
Fax: +44 (0)28 7035 6875

Distribuido en España por:

Martin Vecino S.L.
C/León Nº80
28940 Fuenlabrada (Madrid)
Telf: +34 91 642 44 71
Fax: +34 91 642 30 55
Web: www.martinvecino.com

Las especificaciones de producto pueden ser modificadas sin notificación previa